


# REINIGING EN DESINFECTIE

Hoe schoon is ons **H**uis?

## Acties



ATP metingen\*




Check speelruimtes



Observaties

## Resultaten kliniek



### Check speelruimte (10 punten)



- ✓ 13/22 afdelingen >90% goed
- ✓ >90% schoon/vuil scheiding visueel weergegeven
- ✗ Bij 7/22 afdelingen: Geen chloor tabletten aanwezig op afdeling.
- ✗ Bij 5/22 afdelingen: Vloer niet vrij van materialen.


\* Met ATP kan je oppervlakte vervuiling meten in rlu. Een waarde tot 1500 rlu is acceptabel.  
 schoon <300 rlu  
 acceptabel 300-1500 rlu  
 vervuild 1500-3000 rlu  
 sterk vervuild > 3000 rlu

### ATP resultaten 2018 vs 2019

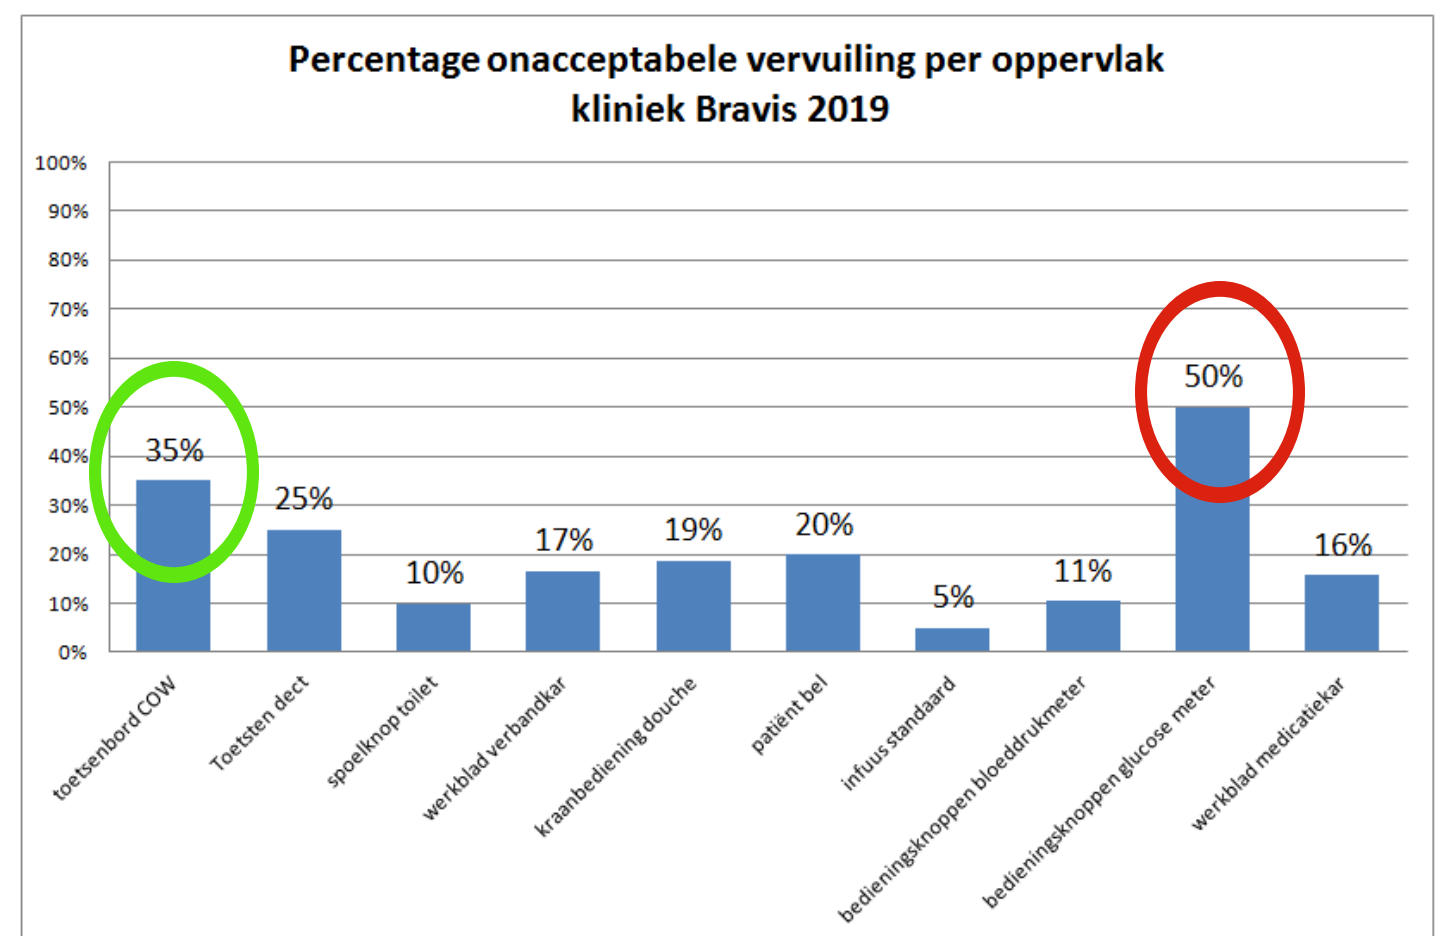


## Resultaten polikliniek

Overzicht oppervlakte vervuiling % vervuild (n=250)



- sterk vervuild 3
- vervuild 10
- acceptabel 49
- schoon 38

### ATP resultaten 2019

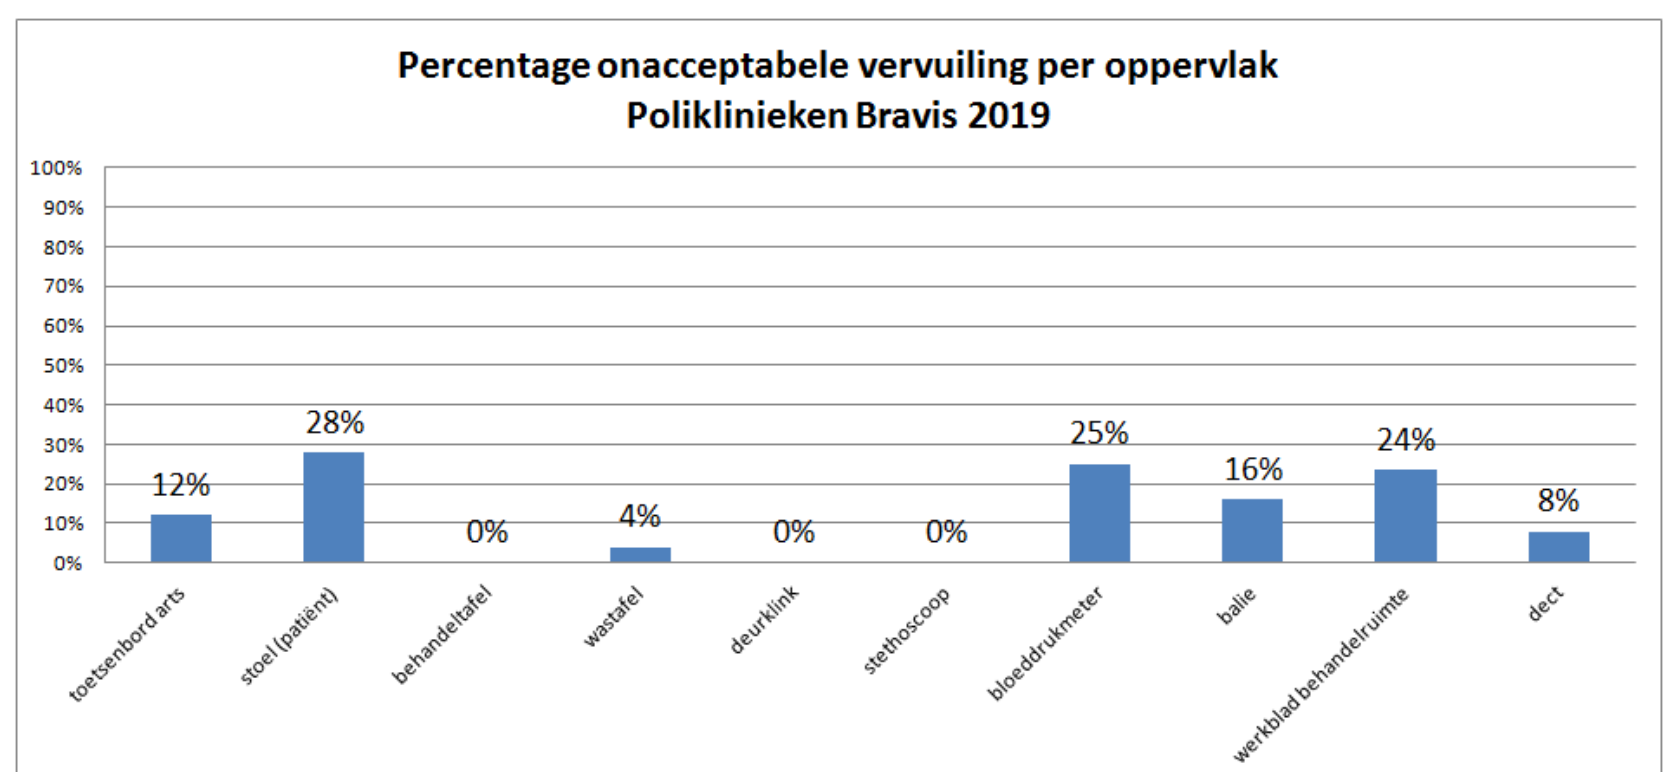

## Conclusie & aanbevelingen

In 2018 is er veel verbeterd op het gebied van reiniging en desinfectie. In 2019 is deze verbetering vastgehouden. Laten we dit de komende jaren ook zo blijven doen!

De glucosemeter is wel een punt van aandacht. Het blijkt dat de oude meter, die in BoZ gebruikt wordt, moeilijk schoon te maken is. Deze staan al op de nominatie ter vervanging en zullen in de loop van 2019 vervangen worden.

